



شرکت ژرفا نگاران دنیای تشخیص

عنوان سند: مستندات ارزیابی عملکرد براساس تکرارپذیری کیت استخراج DNA ویروسی بین دو کارشناس هم سطح
در دو آزمایشگاه مختلف با مبنایگذاری تولید کیت های سری حاضر

کد سند : W02-P15 / VL01

شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	شرح تغییرات
..	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	تدوین اولیه بر اساس ISO13485:2016

کنترل کننده	تهیه کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:
سمت: مسئول کنترل مستندات	سمت: مسئول تضمین کیفیت	سمت: نماینده مدیریت	سمت: مدیرعامل ارئیس هیئت مدیره
نام و امضاء : مناباباگلی	نام و امضاء : امیر منفردان	نام و امضاء : سجاد شریعت	نام و امضاء : امیر منفردان

کد سند : W02-P15 /VL01

عنوان سند : مستندات ارزیابی عملکرد بر اساس تکرارپذیری کیت استخراج DNA ویروسی بین دو کارشناس هم سطح در دو آزمایشگاه مختلف با مبنایگذاری تولید کیت های سری حاضر

شرکت ژرفانگاران دنیای تشخیص

۱- هدف :


هدف از تهیه و بکارگیری این دستورالعمل تشریح فعالیت‌های مربوط به اجرای فرآیندهای ارزیابی عملکرد بر اساس تکرارپذیری کیت استخراج DNA ویروسی بین دو کارشناس هم سطح در دو آزمایشگاه مختلف با مبنایگذاری تولید کیت های سری حاضر می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد :

این نتایج شامل مستندات به دست آمده از ارزیابی تکرارپذیری کیت استخراج DNA ویروسی بین دو کارشناس هم سطح در دو آزمایشگاه مختلف می‌باشد.

۳- شرح عملیات :

۱ درصد از هر ۱۰۰ کیت تهیه شده بصورت رندوم، که بطور کامل از نظر کنترل کیفی تایید شده، انتخاب و در دو آزمایشگاه مختلف توسط دو کارشناس هم سطح با دو دستگاه متفاوت (مدل و برنده دستگاه ها یکسان بود) دقیقاً مطابق با پروتکل کیت برای نمونه یکسان از ۴ منبع مختلف ویروسی (سواب، پلاسمما، سرم، محیط انتقال یونیورسال ویروسی) استخراج شد. این تست برای کل نمونه با بکارگیری فرمول { تعداد تکرار \times تعداد ران کاری \times تعداد روز متواالی } که در این مورد $5 \times 2 \times 3$ می باشد (در مجموع ۳۰ تکرار) بر مبنای غلظت سنجه اسید نوکلئیک استخراجی مورد ارزیابی قرار گرفت. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای ارزیابی تفاوت معنی داری ملاک قرار گرفت. داده ها نشان دادند که کیتها در دو مرکز متفاوت با اجرای دو کارشناس هم سطح، نتایج پایایی دارند بعارت دیگر نتایج بدست آمده وابسته به اپراتور نبوده و غلظت های DNA در شرایط متفاوت اختلاف معنی داری باهم ندارند.

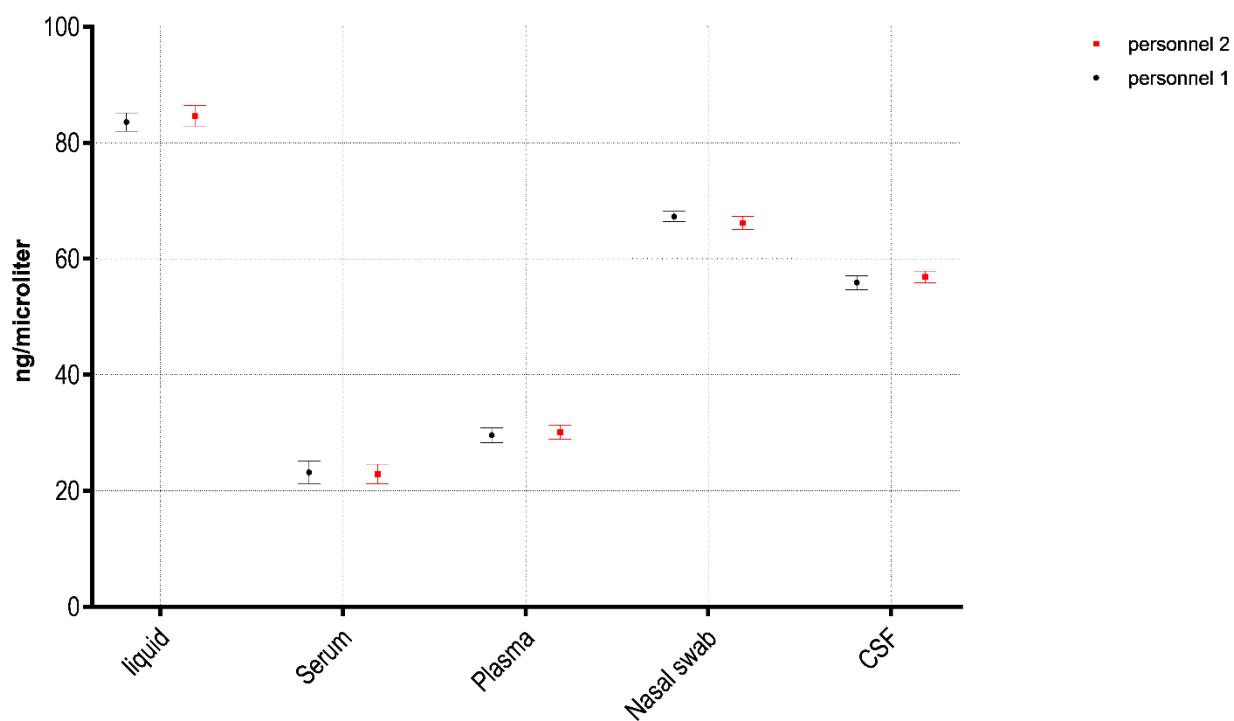

نمودار ارزیابی تکرارپذیری کیت بین دو کارشناس هم سطح در دو آزمایشگاه مختلف برای میانگین غلظت های بدست آمده از هر منبع استخراجی